




AAALAC认证, 动物设施达国际标准

2009 AAALAC

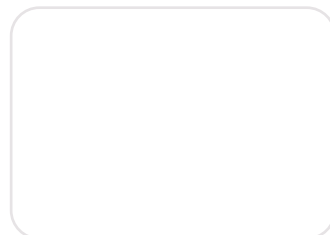

种属	房间数	容量
	61	2260
	62	1720
	14	520
	10	200

先进仪器设备, 助力研发提能增效

大动物实验仪器设备



大动物药效实验分析设备



MSD



Bio-Plex 200



GE Biacore 8K



Molecule Devices SpectraMax iD5



Molecule Devices SpectraM4/M5



Gyrolab xPlore



Molecular Devices



Applied Biosystems 7500
PCR

大动物药效实验病理研究设备



Beckman Coulter AU5800



Sysmex



Sysmex



Sysmex



thermo



Leica Peloris 3





Epredia






Leica


案例1: 复方制剂对巴马小型猪术后急性疼痛模型的镇痛试验

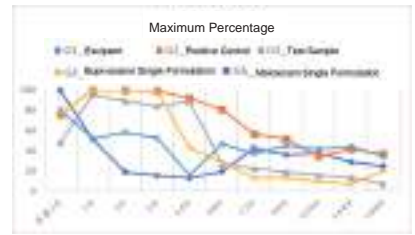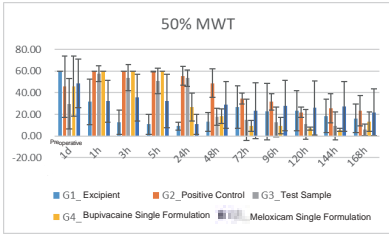

50% MWT

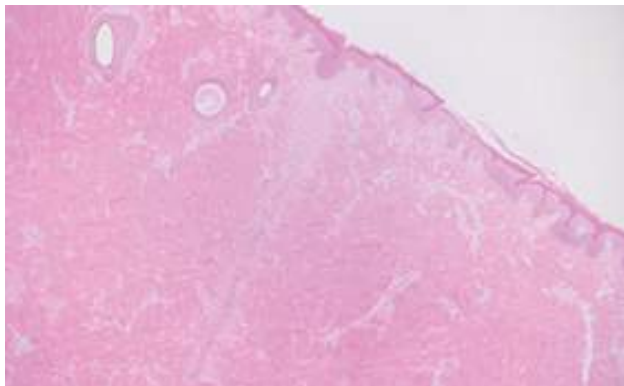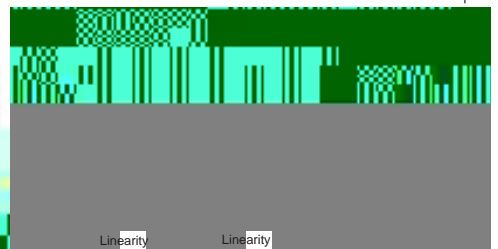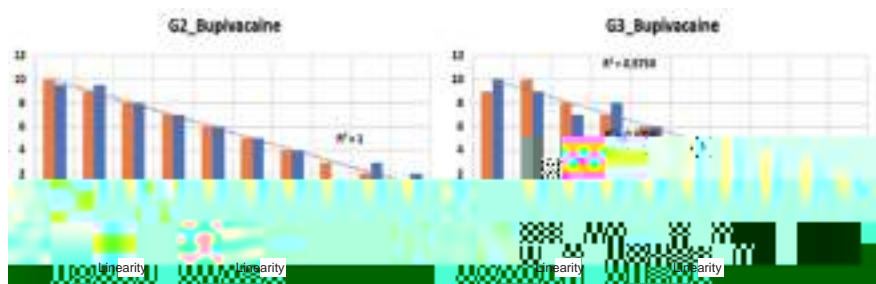

HE

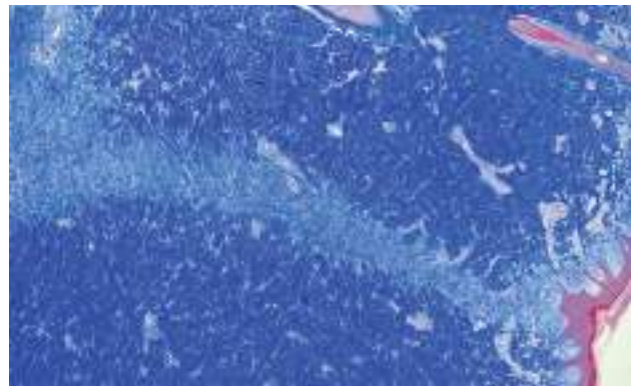

Masson




案例2: 小分子抗凝药对食蟹猴出凝血功能影响



項目	性別	D0				D1				D2			
		平均値 (g)	標準偏差 (g)	最小値 (g)	最大値 (g)	平均値 (g)	標準偏差 (g)	最小値 (g)	最大値 (g)	平均値 (g)	標準偏差 (g)	最小値 (g)	最大値 (g)
体重 (g)	♂	1.00	0.05	0.95	1.05	1.00	0.05	0.95	1.05	1.00	0.05	0.95	1.05
体重 (g)	♀	0.95	0.05	0.90	1.00	0.95	0.05	0.90	1.00	0.95	0.05	0.90	1.00
体重 (g)	♂	1.00	0.05	0.95	1.05	1.00	0.05	0.95	1.05	1.00	0.05	0.95	1.05
体重 (g)	♀	0.95	0.05	0.90	1.00	0.95	0.05	0.90	1.00	0.95	0.05	0.90	1.00



項目	性別	D0		D1		D2	
		平均値 (g)	標準偏差 (g)	平均値 (g)	標準偏差 (g)	平均値 (g)	標準偏差 (g)
体重 (g)	♂	1.00	0.05	1.00	0.05	1.00	0.05
体重 (g)	♀	0.95	0.05	0.95	0.05	0.95	0.05

案例3: 食蟹猴减重实验

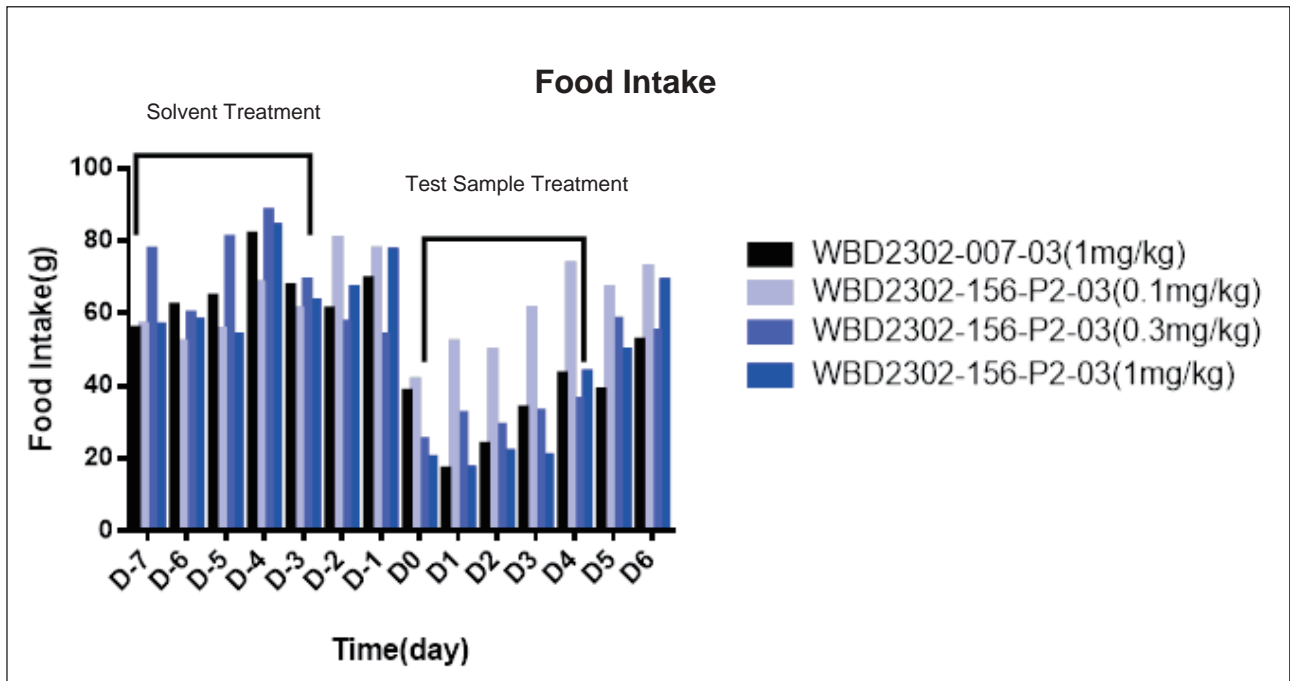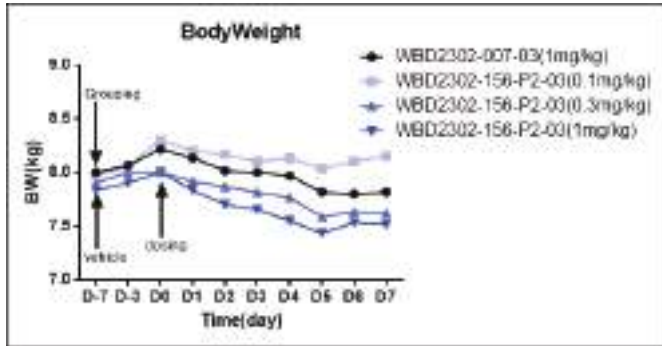


案例4:食蟹猴IVGTT和胰岛素检测实验

IVGTT :

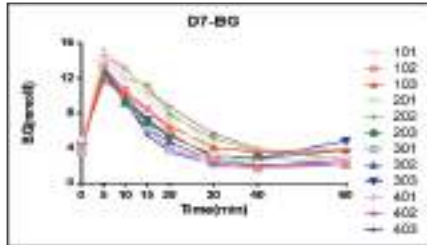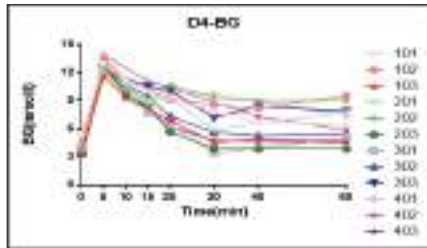

Insulin :

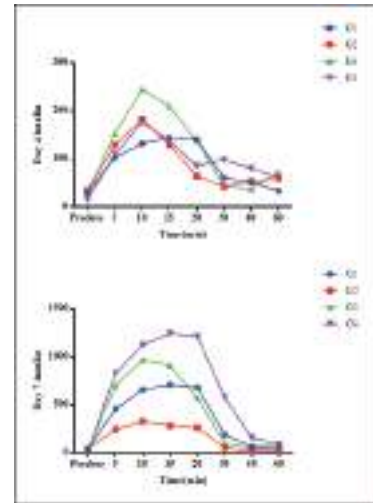

MEDICILON

Email: marketing@medicilon.com